

VenoTrain® curaflow

221

221

Bauerfeind Benelux B.V.
 NL P +31 (0) 23 531-9427
 F +31 (0) 23 532-1970
 BE P +32 (0) 2 527-4060
 F +32 (0) 2 792-5345

PATIENTGEGEVENS | DONNÉES DU PATIENT

Patiëntnaam | Nom du patient :

LEVERANCIER | SOCIETE :

Besteldatum | Date de la commande :

Stempel leverancier |
 Cachet société :

Vorig schanummer | No commande depuis :

Handtekening |
 Signature :

Tweedelig (aub 2 maatbladen gebruiken) | Deux pièces (utilisez 2 feuilles svp)

Been | Jambe

Farben Crème Caramel Zwart |
 Noir Antraciet | Graphite Marine Bordeaux

Compressie | Compression Ccl1 Ccl2 Ccl3 Ccl4

Linker been | Jambe gauche

Rechter been | Jambe droit

Broekgedeelte | Partie ventrale

Aantal | Quantité : Paar | Stuks |
 Paire _____ Pièce _____

Uitvoering | Collant

AD

AG

AGHB

AT

ATU

ATE

BT / B1T (legging)

CT (Capri)

ET (Bermuda)

FT (Wielrenbroek | Pantalon de cycliste)

Boord / bevestiging | Bord / fixation

Noppensiliconenband | Bande silicone boules

breed | large (4,7 cm)

smal | étroite (2,5 cm)

Tailleboord | Bord taille:

Noppensiliconenband | Bande silicone boules

Tailleband | Bande taille

Boord met compressie | Bord avec compression

Gebreide rand | Taille élastique

Opties beenkous | Options collant jambe

Zijdelings schuine boord | Bande laterale en biais

Beenverhoging voorzijde | Surélévation bord cuisse avant

Zonder anatomische knie | Sans genou anatomique

Ritsluiting been | Tirette jambe¹

Voering | Doublure¹

3/4 sil.boord binnen | 3/4 borde silicone

Afwerking kruis | Finition gousset



Standaard | Standard

Open | Ouvert

Alle gegevens in cm opgeven. Verkeerd opgegeven maten komen ten laste van de besteller. Op maat gemaakte producten kunnen niet worden geruild. | Indications en cm. La personne qui commande est responsable en cas de saisie de mesures fausses. Les fabrications sur mesure ne peuvent être échangées.

¹ Lengte en positie vermelden bij opmerkingen /
 Maak een situatiefoto | Longueur et position suivant souhait individuel

Opmerkingen | Remarques :

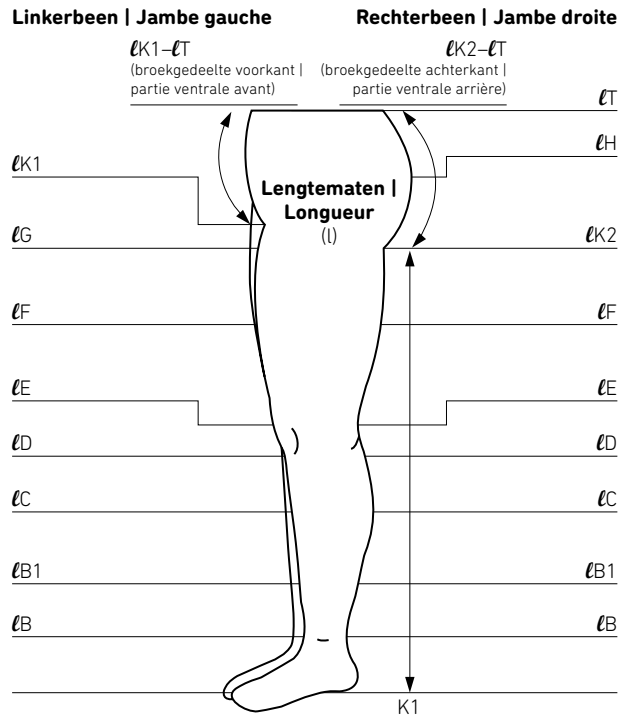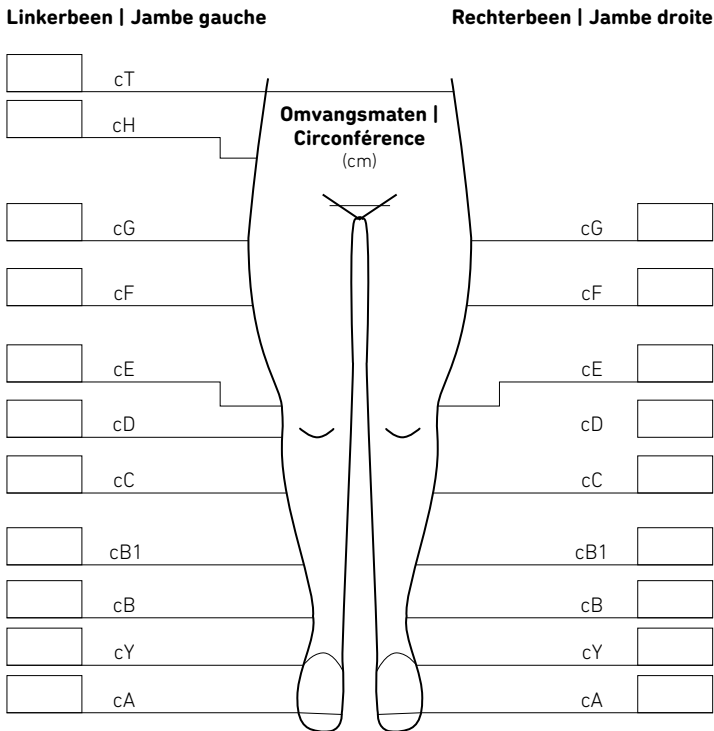

Voet | Pied

Gesloten teenstuk | Pied fermé

Gesloten teenstuk met schuine afwerking | Pied fermé en biais

90° hiel | Talon à 90°

Wreef toename | Elargissement cou-de-pied

Pelotte

Siliconen | Silicone

Schuimstof | mousse

Schuine teenstuk | Pied ouvert a biais

IA mediaal | médiale int.

IA lateraal | laterale ext.

Hallux Valgus

Anatomische voet | pied anatomique

Cx _____ cm l_x _____ cm

Siliconenboordje aan voet | Silicone